

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://atmosmed.nt-rt.ru> || aem@nt-rt.ru


Аспираторы для верхних дыхательных путей

АТМОС

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

НАДЁЖНОСТЬ

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

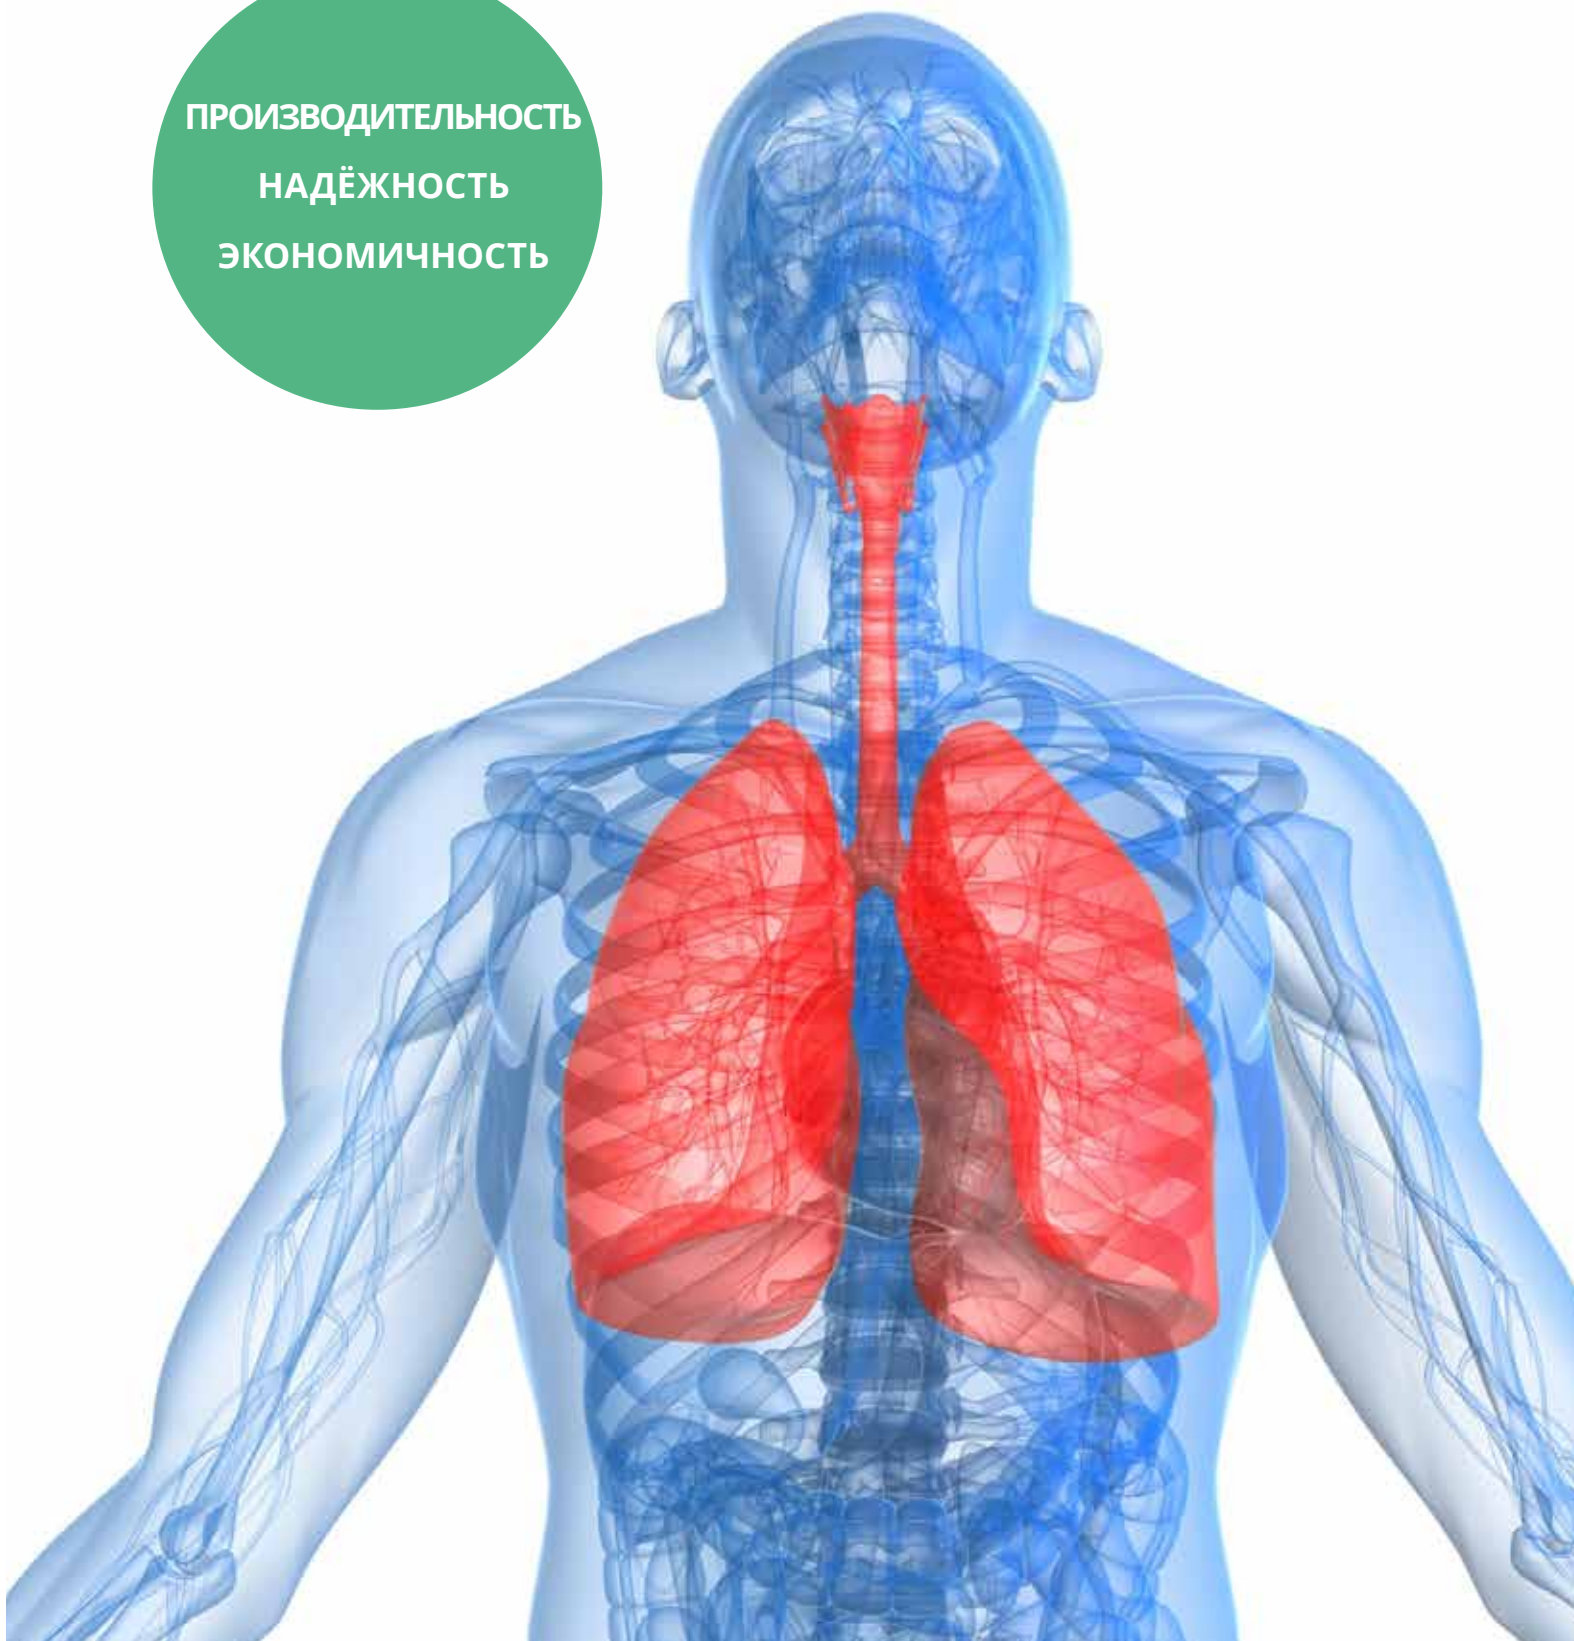

Почему именно аспираторы ATMOS?

Аспирационная санация верхних дыхательных путей – процедура, необходимая в тех случаях, когда у человека затруднена возможность откашливать секрет (слизь, мокроту и т.д.) или эта возможность вообще отсутствует. Подобное состояние возникает в связи с различными заболеваниями или после хирургических вмешательств в области верхних дыхательных путей. Аспираторы для санации верхних дыхательных путей ATMOS – надёжные спутники пациентов, которые из-за своих заболеваний вынуждены ежедневно проводить аспирацию верхних дыхательных путей.

Принцип аспирации заключается в том, что аспиратор создаёт вакуум. При этом газообразные, жидкие и твёрдые вещества/субстанции всасываются через шланг в специальную ёмкость прибора. Мощность аспиратора можно подобрать индивидуально для пациента. Частота проведения процедуры аспирации зависит от индивидуальных потребностей, согласно принципа „так часто, как необходимо, но как можно реже“.

Области применения

- Аспирация секрета после ларингоэктомии
- Аспирация секрета трахеотомии
- Аспирация секрета при заболеваниях с увеличением производства слюны
- Аспирация при некоторых повреждениях дыхательных путей после химиотерапии опухоли
- Аспирация при увеличении отделяемого секрета после некоторых операционных вмешательств
- Бронхиальная аспирация в педиатрии
- Аспирация при анестезии в операционной
- Аспирация секрета при длительной искусственной вентиляции лёгких в интенсивной реанимации
- Аспирация секрета при дисфагии после инсульта
- Гериатрическая гигиена полости рта

Виды аспирации

- Оральная аспирация:
аспиратор секрета через полость рта.
- Трансназальная аспирация:
аспиратор секрета через нос. Этот способ особенно рекомендован для аспирации секрета из области горла.
- Эндотрахеальная аспирация:
аспиратор секрета через воздушную трубку. Используются трубки или трахеоканюли.

Информационная брошюра

Подробную информацию и общие правила проведения аспирации Вы можете найти в информационной брошюре „Аспирационная санация верхних дыхательных путей“. Для получения бесплатной брошюры Также Вы можете найти брошюру в электронном виде на нашем сайте:



С - Класс

Наш аспиратор для санации верхних дыхательных путей для ваших потребностей!


- Синяя, прозрачная, сдвижная защитная панель для защиты панели управления от воздействия внешних воздействий и загрязнений
- Лёгкость и простота санитарной обработки поверхностей прибора
- Наличие точнейшего указателя вакуума и плавного регулятора вакуума
- Контрольное окно для визуальной проверки прибора на „перелив“, для быстрой и простой индикации неисправности прибора



Запатентованная система бесшлангового соединения аспиратора с ёмкостью для секрета ATMOS Direct-Docking-System

С внедрением системы „прямой стыковки“ Direct-Docking-Systems DDS в сегмент малых аспираторов, ATMOS представил новое поколение переносных аспираторов для санации верхних дыхательных путей. До определённого времени существовала опасность повреждения аспиратора при неправильном соединении ёмкости аспиратора шлангом с аспиратором, однако теперь эта проблема решена! С инновационной системой ATMOS ДДС – системой бесшлангового соединения аспиратора с ёмкостью для секрета – никаких проблем. Нет шлангов, нет проблем!

Благодаря неповторимым качествам аспираторов ATMOS®: системе „прямой стыковки“ DDS, эргономике, дизайну и привлекательной цене, ATMOS установил новый стандарт в аспирации верхних дыхательных путей.

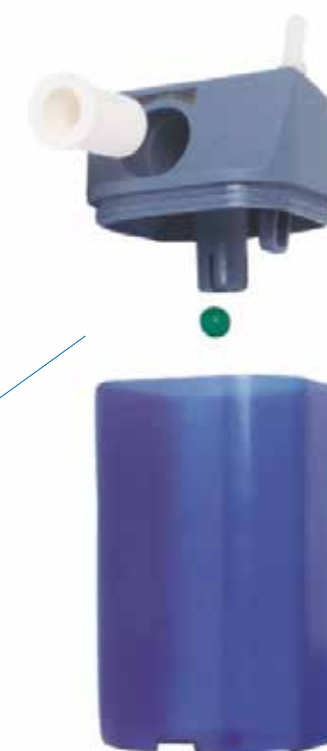

- Фильтр новейшей технологии
- Встроенная защита от переполнения
- Запатентованная система бесшлангового соединения аспиратора с ёмкостью для секрета Direct-Docking-System (DDS)

Переносные, независимые от электросети аспираторы ATMOS для верхних дыхательных путей



Аспиратор ATMOS Battery — аккумуляторный, независимый от электросети:

- Мощность аспирации: 22 ± 2 л/мин
- Потребляемая мощность аккумулятора 12 В DC
продолжительность работы от аккумулятора около 40 мин
- Время зарядки 1,5 часа
- 5-ти уровневая LED-индикация заряда аккумулятора

Аспираторы ATMOS Aspirator — работа от электросети

- Производительность 16 ± 2 л/мин или 26 ± 2 л/мин



Обзор моделей аспираторов

	ATMOS C 161 Aspirator	ATMOS C 261 Aspirator	ATMOS C 161 Battery
Артикул	313.0000.0	313.0100.0	313.0400.0

Очистка и уход за аспираторами



Общие указания

- Аспиратор одновременно может использоваться только одним пациентом, так как нужно принимать во внимание высокую степень вероятности передачи микробов и возбудителей болезней.
- Проводите ежедневный визуальный контроль прибора.
- Применяйте аспиратор только согласно указаниям по применению.
- Используйте для дезинфекции прибора и комплектующих только рекомендованные ATMOS средства.
- Перед каждым процессом очистки необходимо обесточить прибор (выключить из розетки).



Ёмкость для секрета и крышка ёмкости для секрета

Ёмкость для секрета необходимо опустошать после каждого применения. Прополосните ёмкость и крышку под проточной водой со стандартным средством для мытья посуды. В случае застревания каких-либо остатков, удалите их щёткой. ATMOS рекомендует ежедневную дезинфекцию!



Корпус

Корпус прибора необходимо протирать чистым и влажным платком после каждого применения. Мы рекомендуем дезинфекцию корпуса по меньшей мере один раз в неделю.



Антибактериальный фильтр

Этот фильтр предотвращает проникновение бактерий и жидкостей внутрь прибора. Обращайте внимание, чтобы для прибора использовались только оригинальные антибактериальные фильтры ATMOS. В таком случае, смена фильтра понадобится по меньшей мере один раз в неделю. Фильтр необходимо немедленно заменить в трёх случаях: при передаче прибора другому пациенту, при промокании фильтра и его загрязнении.



Шланг аспиратора

Прополаскивайте шланг аспиратора с рекомендованным ATMOS дезинфицирующим раствором по меньшей мере один раз в день. Также прополаскивание проточной водой требуется после каждого применения прибора. Если следовать этим рекомендациям, то аспираторы ATMOS прослужат безупречно в течение многих лет в качестве надежных и гигиеничных вспомогательных средств в амбулаторном, стационарном и домашнем уходе. Замену шлангов ATMOS рекомендует производить примерно через 4 недели, так как они изнашиваются при частом применении и со временем становятся пористыми.

Аспираторы, работающие от электросети

ATMOS C 261 Aspirator / DDS	Артикул
1 Переносной аспиратор, производительность: 26 ± 2 л/мин Плавный регулятор и прецизионный указатель уровня вакуума, градуированная ёмкость для секрета 1 л, крышка ёмкости с тройной защитой от переполнения, которая обеспечивается благодаря новейшей технологии фильтра, встроенной защите от переполнения и системе DDS. Контрольное окно для визуальной проверки прибора на перелив". Комплект поставки: шланг аспиратора, силикон, Ø 6 мм, L = 1,3 м, сетевой кабель, 3 шт. антибактериальный фильтр, соединитель для шланга (регулировка вакуума пальцем), DDS-ёмкость для секрета, 1 л, DDS-крышка ёмкости, инструкция пользователя.	313.0100.0
ATMOS C 161 Aspirator / DDS	
2 Переносной аспиратор, производительность: 16 ± 2 л/мин Описание см. выше. Комплект поставки: шланг аспиратора, силикон, Ø 6 мм, L = 1,3 м, сетевой кабель, 3 шт. антибактериальный фильтр, соединитель для шланга (регулировка вакуума пальцем), DDS-ёмкость для секрета, 1 л, DDS-крышка ёмкости, инструкция пользователя.	313.0000.0

Аккумуляторный аспиратор

ATMOS C 161 Battery / DDS	Артикул
3 Переносной аспиратор, производительность: 22 ± 2 л/мин Плавный регулятор вакуума и прецизионный указатель уровня вакуума, 5-ти-уровневая LED-индикация заряда аккумулятора, продолжительность работы от аккумуляторов около 40 мин, время зарядки 1,5 часа, градуированная ёмкость для секрета 1 л, крышка ёмкости с тройной защитой от переполнения, которая обеспечивается благодаря новейшей технологии фильтра, встроенной защите от переполнения и системе DDS контрольное окно для визуальной проверки прибора на „перелив“. Комплект поставки: шланг аспиратора, силикон, Ø 6 мм, L=1,30 м, сетевой кабель, энергоснабжение электросети 100 - 240 В, 50/60 Гц, соединитель для шланга (регулировка вакуума пальцем); 3 шт. антибактериальный фильтр, DDS-ёмкость для секрета, 1 л, инструкция пользователя.	313.0400.0



1 Артикул 313.0100.0



2 Артикул 313.0000.0



3 Артикул 313.0400.0

Принадлежности

Принадлежности	Артикул
1 Градуированная DDS-ёмкость для секрета, 1 л, синяя, полисульфон	313.0015.0
2 Градуированная DDS-ёмкость для секрета, 1 л, прозрачная, полисульфон	313.0017.0
3 Крышка ёмкости для секрета DDS, синяя, (включая запасной DDS-фильтр 1 шт.)	313.0006.0
4 Соединитель шланга Ø 6 мм	000.0836.0
5 Устройство для наматывания шланга аспиратора	313.0007.0
6 Зарядное устройство для ATMOS Battery, 100 - 240 В~, 50/ 60 Гц	313.0080.0
7 Сумка для переноски прибора, с удобными карманами для хранения расходных материалов. Цвет: чёрный.	313.0011.0
8 Kfz-кабель для ATMOS C 161 Battery, подключение 12 В-	313.0436.0
9 Держатель аспиратора с поворачивающимся универсальным креплением для навешивания прибора на стандартный рельс, штатив, кровать пациента, инвалидные коляски и т. д.	313.0012.0
10 Тележка для прибора на 4-х роликах, для самостоятельного монтажа Габариты (В x Ш x Г): 580 x 425 x 400 мм. Цвет: серо-голубой	320.0070.2
Общие принадлежности	Артикул
11 Короб для гибких катеторов, крепится на тележку, L=340 мм	444.0140.0



1 Артикул 313.0015.0



2 Артикул 313.0017.0



3 Артикул 313.0006.0



4 Артикул 000.0836.0




5 Артикул 313.0007.0



6 Артикул 313.0080.0




7 Артикул 313.0011.0

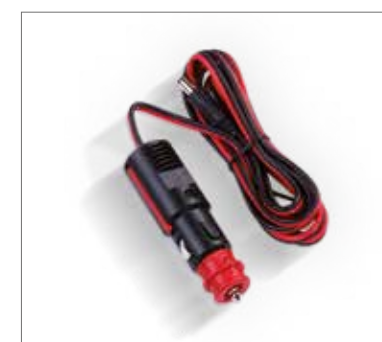

8 Артикул 313.0436.0



9 Артикул 313.0012.0

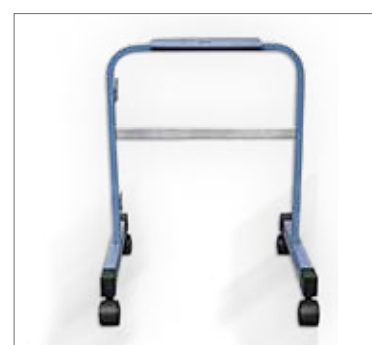

10 Артикул 320.0070.2



11 Артикул 444.0140.0

Расходные материалы

Расходные материалы	Артикул
1 DDS-антибактериальный фильтр с защитой от переполнения, гидрофобный, одноразовый, неавтоклавиремый. Замена после каждого пациента. При использовании одним пациентом замена в среднем через 2 недели. При сильном загрязнении или при смене пациента заменить немедленно. Упаковка 10 штук.	340.0054.0
2 Набор расходных материалов для аспираторов ATMOS C 161 / C 261: шланг аспиратора Ø 6 мм, L = 1,3 м, силикон; 3 х антибактериальный фильтр, 10 х соединитель для шланга (регулировка вакуума пальцем)	313.0160.0
3 Шланг аспиратора, силикон, Ø 6 мм, минимальная поставка 5 м. Обработка при температуре до 200 °C	006.0009.0
4 Шланг аспиратора, силикон, Ø 6 мм, L = 1,30 м, 1 штука в упаковке, обработка при температуре до 200 °C	000.0013.0
5 Соединитель для шланга (регулировка вакуума пальцем), стерильный, неавтоклавиремый, замена после каждого пациента; при использовании одним пациентом замена каждые 2-3 дня. Минимальная поставка 10 штук.	000.0347.0



1

Артикул 340.0054.0



2

Артикул 313.0160.0



3

Артикул 006.0009.0



4

Артикул 000.0013.0



5

Артикул 000.0347.0

Выбор модели aspirатора по области применения

	ATMOS Record 55	ATMOS S 351 OT
Операционная/хирургия	✓	✓
Отделение интенсивной терапии	✗	✗
Стационарное отделение	✗	✗
Отделение скорой помощи	✗	✗
Отделение амбулаторной хирургии	✓	✓
Частная практика	○	○
Стоматология/Ортодонтия	✓	○
Челюстно-лицевая хирургия	✓	○
Оториноларингология	✓	○

ATMOS C 451	ATMOS C 361	ATMOS C 161/ C 261
✓	✓	✗
○	○	✓
○	○	✓
✗	✗	✗
✓	✓	○
✓	✓	✓
✓	○	✗
✓	✗	✗
✓	○	✓

✗ = не подходит ○ = возможно применение ✓ = разработан специально для этой области



Выбор модели aspirатора по особым рекомендациям

	ATMOS Record 55	ATMOS S 351	ATMOS S 351 Natal
Операционная	✓	✓	✓
Липосакция	✓	✗	✗
Эстетическая хирургия	✓	○	✗
Акушерство	✗	✗	✓
Гастроэнтерология	✓	✓	✗
Эндоскопия	○	○	✗
Офтальмология	✓	✓	✗
Дерматология	○	✗	✗
Кардио-, торакальная и сосудистая хирургия	✓	✓	✗
Нейрохирургия	✓	✓	✗

ATMOS C 451	ATMOS C 361	ATMOS S 201	ATMOS C 051	ATMOS C 261/C 161
✓	✓	✓	✓	○
✗	✗	✗	✗	✗
✓	○	✗	✗	✗
✓	✗	✗	✗	✗
✓	✓	✗	✗	✗
✓	✓	✗	✗	✓
✓	✓	✗	✗	○
✓	✓	✗	✗	○
✓	✓	✓	✓	✗
✓	○	✗	✗	✗

✗ = не подходит

○ = возможно применение

✓ = разработан специально для этой области



Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	
Россия +7(495)268-04-70		Казахстан +7(7172)727-132		Киргизия +996(312)96-26-47

https://atmosmed.nt-rt.ru || aem@nt-rt.ru